

计划编码：NDJH-2024-006

合同号：20251011

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：安徽医科大学第一附属医院 DSA（数字减影血管造影系统）

项目采购

项目编号：25AT91071202643

甲方（采购人）：安徽医科大学第一附属医院

乙方（中标人）：苏豪弘业股份有限公司

签订地点：安徽医科大学第一附属医院

签订日期：2025年7月16日

安徽医科大学第一附属医院（以下简称：甲方）通过安徽安天利信工程管理股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，苏豪弘业股份有限公司（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

一、产品名称、型号规格、数量、单位、金额：（单位：元）

产品名称	品牌	产地	规 格 型 号	配 置	单 位	数 量	单 价	金 额
DSA(数字减影血管造影系统)	GE	北京	Allia IGS Pulse	见后配置清单	台	1	839900 0	8399000

合计金额（小写）： 8399000

合计人民币金额（大写）：捌佰叁拾玖万玖仟元整。

备注：1. 若渠道合同，注明合同有效期（具体时间）。
2. 若有配套耗材或易损件，请在附件：配套耗材或易损件明细表填写。

附件：配套耗材或易损件明细表

（单位：元）

产品名称	生产 厂家、 品牌	规 格 型 号	单 位	单 价	数 量	金 额
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

备注：有效期至 / 年 / 月 / 日

1.3 价款

本合同总价为：¥ 8,399,000.00 元（大写：人民币 捌佰叁拾玖万玖仟元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	数字减影血管造影系统	8,399,000.00
2	安装、调试、检验、培训等	包含在投标总价内
3	悬吊式高压注射器	包含在投标总价内
4	DSA 用无铅防辐射套装(包括分体式套装、铅帽、围脖)	包含在投标总价内
5	铅屏风 2 套	包含在投标总价内
6	双向对讲通话系统	包含在投标总价内
总价		8,399,000.00

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：采购合同签订前，乙方支付合同金额的 2.5% 作为履约保证金到甲方指定账户，供货安装并验收合格后退还。本项目全部货到安装验收合格，乙方开具金额为合同总金额的增值税专用发票后按照合同价款一次性付清；

1.4.2 发票开具方式：乙方向甲方开具金额为合同总金额的增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：乙方接甲方通知后 30 天内；

1.5.2 交付地点：安徽医科大学第一附属医院；

1.5.3 交付方式：陆运，乙方免费将货物送达甲方指定地点。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.2% 计算，最高限额为本合同总价的 2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么

乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.2%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（②）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方: _____ (单位盖章) 乙方: _____ (单位盖章)

法定代表人

法定代表人

或授权代表(签字) 

或授权代表(签字) 

时间: 2025 年 7 月 16 日

时间: _____ 年 合同专用章

乙方账户信息

户名: 苏豪弘业股份有限公司

账号: 484558191179

开户银行: 中国银行南京市中华

路支行

17768113268

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条

款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外, 乙方交付的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 没有通用方式的, 应当采取足以保护货物的包装方式, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要, 包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知, 详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时, 对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查, 以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求, 但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作, 乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间, 甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方, 双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要, 向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等, 甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意, 任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料, 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等, 并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系, 并提供相关内部规章制度给甲方, 以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场

地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
	(1) 卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起 <u>48</u> 个月
	(2) 卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 <u>7</u> 天 <u>24</u> 小时（工作时间）。
	3) 卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 <u>4</u> 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 <u>24</u> 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
售后服务承诺	(4) 如卖方在接到买方维修通知后 <u>48</u> 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
	5) 如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 <u>168</u> 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。如果卖方未按照规定时间到场处理故障，每次按 200 元支付违约金，并从质保金中直接扣除。
	((6) 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 <u>2</u> 小时内到达现场。

配置清单


配置清单

产品名称	品牌	产地	规格型号	单位	数量	单价	金额
数字减影血管造影系统	GE	中国	Allia IGS Pulse	套	1	8,399,000.00	8,399,000.00
原厂三维质控校正模	/	/	/	套	1	/	包含在投标总价内
头托	/	/	/	套	1	/	包含在投标总价内
悬吊式高压注射器	/	/	/	套	1	/	包含在投标总价内
DSA用无铅防辐射套装	/	/	/	套	10	/	包含在投标总价内
铅屏风	/	/	/	套	2	/	包含在投标总价内
双向对讲通话系统	/	/	/	套	1	/	包含在投标总价内
总价：人民币捌佰叁拾玖万玖仟元整							


详见以下详细配置清单

Allia IGS Pulse 配置清单

序号	中文描述	英文描述
1	Allia IGS Pulse 单极球管 DSA 造影系统	Allia IGS Pulse with 31cm Detector
1.1	Allia IGS Pulse-31cm 核心系统	Allia IGS Pulse -31 Finish Good Core System
1.1.1	三轴等中心机架	LC-3 Axis positioner
1.1.2	“盖亚”高压发生器	Gaia 100KW MultiPulse Power Unit
1.1.3	“极地之心”单极 X 射线管	Performix Pulsar X MonoPolar

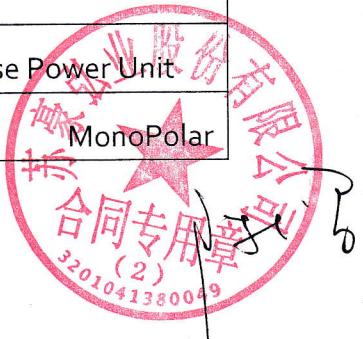

		X-Ray Tube
1.1.4	MFD 限束器	MFD Collimator
1.1.5	剂量监控系统和虚拟限束器	Integrated Dose Monitoring and Virtual Collimation
1.1.6	自动电子束光器	Automated Electronic Shutter
1.1.7	图像显示风格定制	Dose IQ customization
1.1.8	数字化 DL 主机系统	DL Digital system
1.1.9	图像采集软件包	Image Acquisition
1.1.10	DICOM 网络组件	Networking DICOM
1.1.11	基础应用软件包	Application Software
1.1.12	检查床平移装置	Table Panning Device with 5m cable
1.1.13	8KVA 不间断电源	8 KVA UPS
1.1.14	电源分配单元	NPA PDU
1.2	Omega V 检查床	Omega V Table
1.3	31cm 数字平板探测器	31cm Digital Flat Panel
1.4	妙控触屏	IGS Touch Panel
1.5	红外发射和接收装置	IRK
1.6	输液架及固定杆	I.V. POLE & Mount
1.7	I-Box 装配组件	I-Box Assembly v2
1.8	妙控面板	Allia Mushroom with clamp
1.9	妙控触屏线缆组	Cable set for table UI
1.1	主系统控制线缆	Omega System Cable AIO
1.11	检查床床垫外罩	Slicker cover
1.12	手臂支撑板	One Pair of Clear-Vu Arm supports
1.13	快速束缚带	Quick strap-3" X 30 FT
1.14	预安装组件	Pre-installation package
2	AutoRight PLUS+ 图像采集参	AutoRight Acquisition Parameters

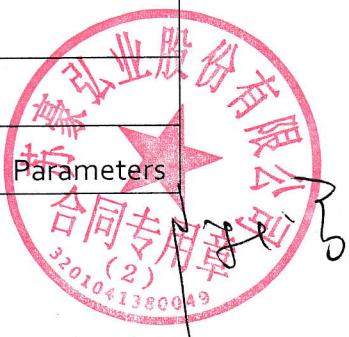

	数调节	Optimization
3	AutoRight PLUS+ 剂量智能监控	AutoRight Dose Optimization
4	“极地之心”阴极电流瞬发技术	Cathode Real-time Adjustment
5	“极地之心”恒冷技术	Constant Cooling Technology
6	有线脚闸	Wired Footswitch
7	妙控面板挂件	Touch panel Clamp
8	滑轨 4 监视器吊架	Ergo Suspension
9	AW In-Room 显示器	AW 48cm (19") Color LCD In Room Monitor
10	DVI 扩展单一接口	DVI Extender Single Link
11	标准位置防碰撞包	Standard positioning & Anti-collision package
12	冠脉介入增强包	PCI ASSIST
13	混合路径图	Blended Roadmap
14	定量分析包	Quantitative Analysis Package
15	冠脉旋转造影	INNOVA SPIN
16	650 帧高清 HDCT	3DCT HD
17	HDCT 去金属伪影	3DCT HD MAR
18	HDCT 呼吸抑制	3DCT HD Motion Freeze
19	减影三维	Subtracted 3D
20	“心三维”3D Stent 冠脉支架三维成像	3D Stent
21	AW VolumeShare 7 医学图像处理工作站 发布版本 AW 4.7	AW VS7 WORKSTATION
22	AW 控制室彩色液晶显示器	AW WORKSTATION MONITORS
23	AW 中文键盘	AW Chinese Keyboard



24	Cardiac X-ray Analysis X 射线 医学图像处理软件	Cardiac Analysis
25	Volume Viewer 医学图像处理 软件	VOLUME VIEWER INTERVENTIONAL
26	NMPA 附录	NMPA DOC Addendum
27	臂托	HB-1 Armboard
28	臂托垫子	HB-1 Armboard Pad
29	机架底座	Base Plate LC
30	安装用推车	INNOVA LC DOLLY
31	高保真对讲系统	Clarson Apparatebau GmbH
32	悬吊 X 射线防护屏风	X-Ray Protective Shield
33	LED 手术灯	Examination Lamp
34	床旁铅帘	Huaren Table Shield
35	高清 19 寸显示器	EIZO MX19 4 Monitor with cable, DVI-D
36	原厂三维质控校正模	3D Calibration Suitcase
37	心脏疾病 ASSIST 解决方案	VALVE ASSIST 2
38	自动去骨分析高级应用软件包	Autobone Xpress
39	血管测量分析高级应用软件包	VesselIQ Xpress
40	原厂三维质控校正模	
41	头托 1 套	
42	悬吊式高压注射器 1 套	
43	DSA 用无铅防辐射套装 10 套	
44	铅屏风 2 套	
45	双向对讲通话系统 1 套	



售后服务承诺

GE 智慧服务,为您提供非凡的客户体验!秉承“精智服务、恒久守护”的理念,我们将从“卓越运营、赋能临床、非凡发展”三大方面为客户提供全面的服务解决方案,在为客户创造高质量的医疗设备保障的同时,以高水准的增值服务,帮助客户同步提升社会和经济效益。期待成为您信赖的医疗设备资产全生命周期管理的合作伙伴。

1. GE 设有专用报修电话,保证在接到设备故障报修通知后,维修工程师 2 小时内响应,6 小时内到达现场检修,保修期内外(包括休息日和节假日)均能派出维修工程师到达现场维修
2. 提供整机免费保修,保修期自设备安装完毕,双方签署验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行,保证全年开机率(按 365 天/年计算)不低于 95%,如达不到此标准,需按 1:3(停机一天延长三天)天数延长,延长期内出现停机按同样比例要求延长保修期。
3. **整机免费保修期 4 年**(包括球管、高压发生器、探测器、第三方产品等),换后的零部件质保期从更换之日起计算,提供的配件必须为原厂,且不低于原配件的规格型号。
4. 保修期满后的三年内的保修价格,服务内容包含提供周期维护保养(PM)≥4 次,并提供标准维护保养报告,提供具体全保一(含球管)、全保二(不含球管)、技术保、单次保报价。如下:

报价项目	报价	备注
全保一(含球管)	人民币 50 万元	一年及三年同价,年保修价格<7% 投标总价(设备自身价格,不含第三方产品及机房改造费用等)(包括球管)且不超过 50 万元
全保二(不含球管)	人民币 30 万元	一年及三年同价,年保修价格<4% 投标总价(设备自身价格,不含第三方产品及机房改造费用等)且不超过 30 万元
技术保	人民币 180,000 元/台/年	无
单次保(即保修期外单次人工维修)	6000 元/次	每个故障含一次报修的多个故障,三个月内该故障含一次报修的多个故障不再重复收费(零配件价格享有本次投标的优惠折扣价格)



承诺能提供不少于 10 年的原厂保修服务。

5. 软件升级开放（费用包含在报价中）：所投设备终身软件升级，免费质保期内提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对要求的软件功能终身开放。并提供设备远程维修支持（费用包含在报价中）。
6. 定期保养：在产品的保修期内，按照产品手册的规定，GE 公司客户服务部提供定期维护保养，包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。确保设备良好性能状态，预先解决潜在问题，预防故障的发生，减少意外宕机时间。
7. 厂家 GE 公司医疗系统在全国设有 40 个办事处和维修站，目前在中国的专业维修工程师近千名，驻扎在全国 100 多个城市，形成了遍布全国的维修服务网络。确保用户能够得到最贴近的服务。
8. 厂家 GE 医疗中国客户服务部拥有完善的质量管理体系，通过 ISO27001、ISO13485、ISO9001 认证，给予中国医院值得信赖的质量与信息安全承诺。
9. 全国客户免费电话 400-812-8188，全年无休，365 天在线提供客户报修、技术咨询及临床应用支持。免费提供设备远程维修支持
10. 厂家 GE 公司医疗系统在北京经济技术开发区和上海外高桥保税区设有保税备件库，另外还有 8 个省级库房和 11 个小型转流库覆盖全国，保证备件更快速地送达基层偏远地区。


11. 零部件报价请查看下列：

序号	维保内容	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	球管	个	700,000	700,000	
2	平板探测器	套	1,233,573	1,233,573	
3	位置传感器	套	19,683	19,683	
4	脚踏	套	33,207	33,207	
5	图像工作站	套	850,000	850,000	
6	运动控制CPU板	套	59,846.64	59,846.64	

12. 卖方应免费对买方操作、维修人员（原厂培训）进行一定时期内分期分批（不少于 3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。



-
13. 随机提供操作说明书(含中英文)及维修说明书, 并提供专用维修工具(价值不小于 3000 元)
 14. 免费提供设备远程维修支持。

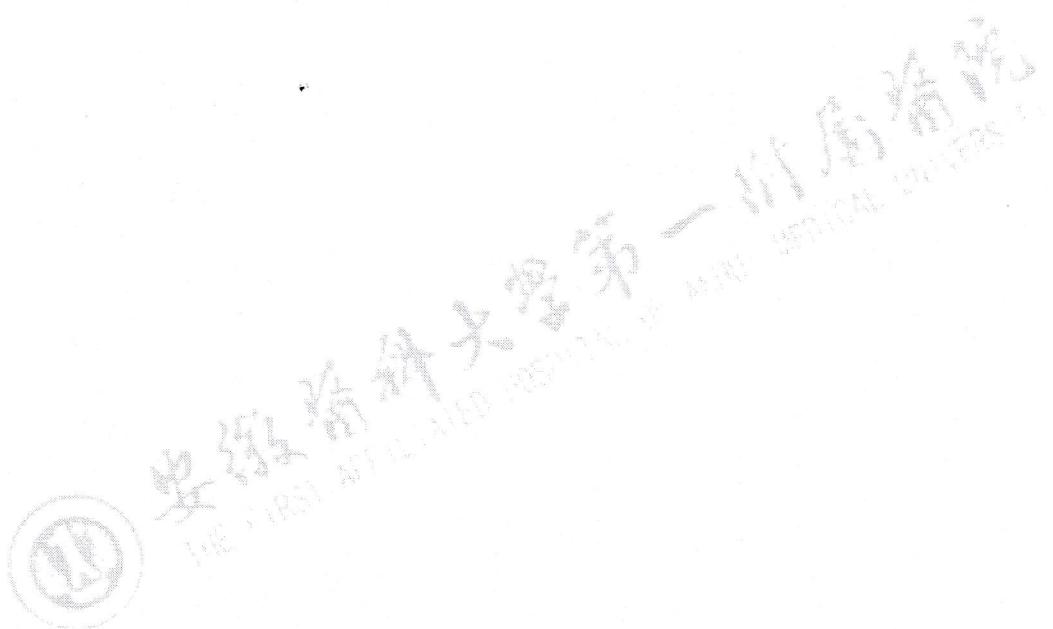

中标通知书

政府采购

中 标 通 知 书





政府采购 中标通知书

编号: 25AT91071202643

苏豪弘业股份有限公司:

你单位参与我公司组织的安徽医科大学第一附属医院 DSA (数字减影血管造影系统) 项目的公开招标(项目编号/包号: 25AT91071202643-001), 经评标委员会评审, 被确定为中标人。

中标金额: 8399000.00 元 (大写: 人民币捌佰叁拾玖万玖仟元整)

货物名称、品牌型号: 数字减影血管造影系统、GE/Allia IGS Pulse

交货期、质保期: 合同签订后, 接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。自验收合格之日起整机质保 4 年, 更换后的零部件质保期从更换之日起计算。

请你单位在收到中标通知书后 7 个工作日内, 到安徽医科大学第一附属医院与招标人签订合同。逾期不与招标人签订合同的, 视为放弃中标资格。

安徽安天利信工程管理股份有限公司
2025 年 06 月 05 日

公司地址: 合肥市蜀山区蜀鑫路 69 号 (创业大道与蜀鑫路西南角)

联系人: 张乐乐 电话: 18205608476

附件：分项报价表

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	▲数字减影血管造影系统	GE\Allia IGS Pulse	北京/北京通用电气华伦医疗设备有限公司	套	1	8,399,000.00	8,399,000.00	
2	安装、调试、检验、培训等	GE\Allia IGS Pulse	北京/北京通用电气华伦医疗设备有限公司	套	1	/	/	包含在投标总价内
3	悬吊式高压注射器	/	/	套	1	/	/	包含在投标总价内
4	DSA 用无铅防辐射套装(包括分体式套装、铅帽、铅脖)	/	/	套	10	/	/	包含在投标总价内
5	铅屏风 2 套	/	/	套	2	/	/	包含在投标总价内
6	双向对讲电话系统	/	/	套	1	/	/	包含在投标总价内
合计(元)		人民币 8,399,000.00 元 (捌佰肆拾玖万元整)						

投标人电子签章： 

日期：2025年1月10日

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

附件：分项报价表

附表1 质保期内条件及易操作分项报价表

项目编号：26AT91071202643 标包号： / 货币单位：人民币

序号	货物(服务)名称及规格型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
1	15. 球管	1	个	包含在投标总价内	包含在投标总价内	GE	GE	北京	北京	
2	数字平板探测器	1	个	包含在投标总价内	包含在投标总价内	GE	GE	北京	北京	
3	束光器	1	个	包含在投标总价内	包含在投标总价内	GE	GE	北京	北京	

附表 2 专用工具分项报价表

项目编号：25AT91071202643 标题号： / 货币单位：人民币

序号	货物(服务)名称	规格型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
1	Phantom 梯控机 梯体	Phantom 梯控机 梯体	1	套	包含在投标总价内	包含在投标总价内	诚	诚	北京	北京	北京
2	专用校准工具包	UVA alignment tools	1	套	包含在投标总价内	包含在投标总价内	诚	诚	北京	北京	北京
3	设备安装工具包	Installation kit	1	套	包含在投标总价内	包含在投标总价内	诚	诚	北京	北京	北京
合计(此表价格含在投标总价内)										/	

附表 3 项目期外条件及易操作分项报价表

项目编号：25ATB1071202643 标包号： / 货币单位：人民币(元)

项目编号: 25ATB1071202643 标包号: / 币种单位: 人民币(元)											
序号	货物(服务)名称	規格型	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
1	AC-DC 电源 Module Assy	DC-DC Module Assy	1	个	73,852.00	73,852.00	GE	GE	北京	北京	
2	电源连接板 Interconnect Board	Power Interconnect Board	1	个	18,482.00	18,482.00	GE	GE	北京	北京	
3	气压控制板 PCH Board PBA	PCH Board PBA	1	个	44,217.00	44,217.00	深	(深)	北京	北京	



附件：分项报价表


附表 4 质保期外维保价格清单

项目编号：_25AT91071202643 标包号：_ 货币单位：人民币（元）

(此表价格不含在投标总价内)

注：此表根据招标文件《第三章 采购需求》相关要求进行填报，以下格式可自行扩展。

序号	维保内容	维保时间	单价(元)	总价(元)	备注
1	球管	/	700,000	700,000	球管价格：10% 投标总价（设备 自身价格，不含 第三方产品及 维修工时及耗 电量等）
2	平板探测器	/	1,233,573	1,233,573	
3	位置传感器	/	19,683	19,683	
4	脚踏	/	33,207	33,207	
5	图像工作站	/	850,000	850,000	
6	运动控制 CPU 板	/	59,846.64	59,846.64	



安医大一附院供应商廉洁购销合同

为认真贯彻党中央、国务院治理医药购销领域商业贿赂的重要决策和部署，进一步加强医疗卫生行风建设，严肃行业纪律，进一步规范医药领域购销行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，根据国家卫生计生委、国家中医药管理局文件《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》（国卫办发【2013】49号）和《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号），经甲、乙双方同意签订廉洁购销合同并予以共同遵守：

一、双方应严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规以及相关政策的规定和医药购销领域治理商业贿赂的有关文件精神。

二、业务活动必须坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方的利益，严格执行供应合同的规定。

三、甲方购进药品、医疗设备、器械、耗材等产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价格外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

四、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映。

五、甲方工作人员不得为乙方非法统计药品、耗材销售数量等有

关信息。

六、乙方不得暗中给予甲方工作人员财物或其他利益。

七、乙方来医院洽谈业务，必须在工作时间到甲方相关科室联系洽谈，不得到临床、门诊推销医药产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈。

八、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的相关法律、法规，严格执行合同条款，不得以次充好、降低产品质量，做到诚信经营。

九、乙方如出现有上述违法违纪行为，一经查实，甲方有权终止合同、列入“供应商商业贿赂不良记录”，两年内不再购入其药品、医用设备和医用耗材；给医院造成经济损失的应予以赔偿；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。“供应商商业贿赂不良记录”在安医大一附院、安徽省卫生计生委等网站予以公布；

十、甲方工作人员如违反上述条款的，甲方将按国家法律法规和医院有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的移交司法机关追究刑事责任。

十一、本廉洁合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。自签订之日起生效。

